



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 630 657 A1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **94108025.1**

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **A61M 25/01, A61M 25/00**

(22) Anmeldetag: **25.05.94**

(30) Priorität: **24.06.93 DE 4320962**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**28.12.94 Patentblatt 94/52**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT CH DE ES FR GB IT LI NL**



(71) Anmelder: **Osyka, Peter, Dr. Ing.**  
**Basler Strasse 109**  
**D-79639 Grenzach-Wyhlen (DE)**

(72) Erfinder: **Osyka, Peter, Dr. Ing.**  
**Basler Strasse 109**  
**D-79639 Grenzach-Wyhlen (DE)**

(74) Vertreter: **Schmitt, Hans, Dipl.-Ing. et al**  
**Patentanwälte,**  
**Dipl.-Ing Hans Schmitt,**  
**Dipl.-Ing. Wolfgang Maucher,**  
**Dipl.-Ing. RA H. Börjes-Pestalozza,**  
**Dreikönigstrasse 13**  
**D-79102 Freiburg (DE)**

(54) **Katheter aus einem biegsamen Kunststoffschlauch.**

(57) Ein Katheter (1), welcher von einem biegsamen Kunststoffschlauch gebildet ist, hat in seinem Inneren einen hohlen Kanal (7) und an seinem distalen Ende einen auslenkbaren Bereich (4), um beim Einführen in Abzweigungen beispielsweise von Blutgefäßen gesteuert werden zu können. Zum Auslenken des Bereiches (4) dient ein exzentrisch zur Mitte verlaufendes Zugelement (5), welches von einer eigenen Führung umschlossen ist. Der Katheter (1) hat dabei einen regelmäßigen kreisförmigen, ovalen oder ellipsenförmigen Querschnitt und das Zugelement (5) und seine Führung sind innerhalb des Umrisses dieses Querschnittes untergebracht. Damit der Katheter nur in seinem auslenkbaren Bereich (4) und nicht in dem dazu hinführenden Bereich gekrümmt wird, wenn an dem Zugelement (5) eine Zugkraft aufgebracht wird, weist der Katheter (1) eine bis zu dem auslenkbaren oder biegsamen Bereich (4) etwa parallel zu dem Zugelement (5) verlaufende, den nicht auslenkbaren Bereich aussteifende, aber etwas biegsame Bewehrung ebenfalls innerhalb des Katheterquerschnittes auf. Diese Bewehrung kann ein das Zugelement (5) als Führung in sich aufnehmendes Führungsrohr (8) aus Metall oder hartem Kunststoff und/oder ein weiteres Zugelement (15), welches parallel zu dem bewegbaren Zugelement (5) auf einer etwa auf einem Durchmesser gegenüberliegenden Seite des Katheters fest installiert ist und nur bis zu dem auslenkbaren Bereich (4) verläuft.

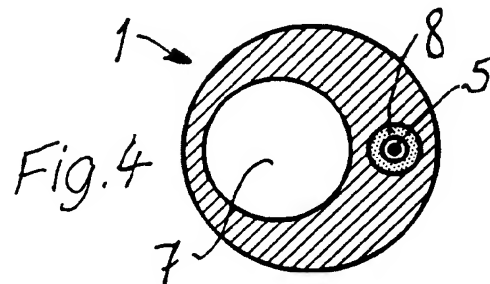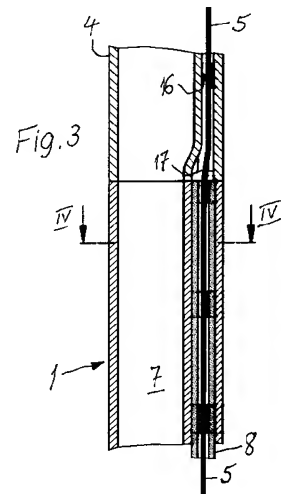

EP 0 630 657 A1

Die Erfindung betrifft einen Katheter mit wenigstens einem in seinem Inneren verlaufenden hohlen Kanal oder Lumen, welcher Katheter im wesentlichen von einem biegsamen Kunststoffschlauch gebildet ist, wobei das distale Ende des Katheters mittels eines gegenüber seiner axialen Mitte exzentrisch angeordneten, über die wesentliche Länge des Katheters verlaufenden Zugelementes zum mehr oder weniger starken Biegen und dadurch zum Steuern des Spitzes des Katheters für den Eintritt in Verzweigungen des Körperhöhlensystems, zum Beispiel Blutgefäße, elastisch biegsam oder auslenkbar ist und wobei das Zugelement bis zu dem auslenkbaren Bereich von einer eigenen Führung umschlossen ist, wobei das Zugelement und seine Führung innerhalb des Umrisses des Querschnittes des Katheters verläuft.

Im medizinischen Bereich werden seit Jahren Katheter verwendet, die im wesentlichen aus einem Kunststoffschlauch bestehen und einen oder mehrere in Längsrichtung verlaufende Kanäle (Lumen) aufweisen. Bezüglich ihrer Steifigkeit gibt es bei diesen Kathetern je nach Anwendungsart Unterschiede, das heißt die Katheter können sehr flexibel aber auch sehr steif sein oder einen dazwischenliegenden Steifigkeitsgrad haben, womit mit der Steifigkeit in der Regel auch die Torsionsstabilität wächst. Das distale Ende ist oft vorgeformt, so daß sich im begrenzten Maße durch Verdrehen des Katheters eine Steuerung seiner Spitze durchführen läßt.

Für weiche Katheter sind Führungsdrähte bekannt, die vor dem eigentlichen Katheter in den Körper eingeführt und zum Zielort vorgeschoben werden. Über diese Führungsdrähte werden dann die eigentlichen Katheter geschoben.

In vielen Fällen ist es wünschenswert, vom proximalen Ende des Katheter aus sein distales Ende, nämlich die Katheterspitze in einem möglichst weiten Bereich steuern zu können und dazu zu krümmen, um diese gekrümmte Spitze des Katheters in feine Verzweigungen des Körperhöhlensystems, zum Beispiel in Blutgefäße und deren Abzweigungen hineinführen zu können. Eine weitere Forderung besteht darin, mit Hilfe solcher steuerbarer Katheter Körperhöhlen abtasten und untersuchen zu können, zum Beispiel im Herzen, um dann mit Hilfe von Lichtleitern endoskopische Aufnahmen oder eine Laserstrahlbehandlung durchführen zu können.

Durch einen Kanal des steuerbaren Katheters lassen sich auch beispielsweise Instrumente (Biopsiezangen) oder Arzneimittel und Pharmaka einführen und applizieren. Auch mit Elektroden versehene Sonden können durch den Kanal des Katheters eingeführt werden, um zum Beispiel am Herzen elektrische Potentiale abzutasten oder eine Hochfrequenzablation durchführen zu können. Durch

das Lumen des Katheters kann auch Flüssigkeit abgesaugt, können Verunreinigungen beseitigt oder Instrumente diagnostischer oder chirurgischer beziehungsweise therapeutischer Art eingeführt werden.

Aus der DE-39 20 707 A1 ist ein Katheter der eingangs erwähnten Art bekannt, welcher eine Steuerung der Spitze durch einen exzentrisch angeordneten Zugdraht erlaubt. Dabei ist die Führung für diesen Zugdraht in einem gegenüber dem übrigen Umriss des Katheters seitlich versetzen, parallel zum eigentlichen Katheter verlaufenden Wulst untergebracht und am Ende dieses Wulstes tritt der Zugdraht frei aus und greift an das dem gegenüber überstehende Ende des Katheters, um dieses durch die Zugkraft verformen zu können. Der teilweise und insbesondere im distalen Ende freiliegende Führungsdraht kann vor allem bei einer Anwendung im Herzen und insbesondere bei einer Anwendung im Ventrikel gefährlich werden, da vor allem die Herzklappen durch diesen Draht verletzt werden könnten. Darüberhinaus ist der entlang dem Katheter verlaufende zusätzliche Wulst als ungünstig für die Herstellung und auch die Handhabung anzusehen, weil der entsprechende Teil des Katheters in unterschiedliche Richtungen unterschiedliche Biegsamkeiten hat. Darüberhinaus besteht bei einem derartigen Katheter insbesondere aus weichem oder flexiblem Werkstoff die Gefahr, daß bei einer Betätigung des Zugelementes nicht nur die steuerbare Spitze, sondern der Katheter über seine gesamte Länge gekrümmt wird.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, einen Katheter der eingangs erwähnten Art zu schaffen, mit welchem ein Krümmen des zu dem biegsamen Bereich führenden Katheterendes durch die Betätigung des Zugelementes vermieden ist, dennoch aber das Zugelement im biegsamen Bereich keine Verletzungsgefahr bewirkt und ein gegenüber dem Katheter-Querschnitt vorstehender Wulst vermieden wird.

Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, daß bis zu dem auslenkbaren oder biegsamen Bereich des Katheters parallel zu dem Zugelement eine den Katheter gegenüber seinem auslenkbaren Bereich aussteifende Bewehrung ebenfalls innerhalb des Katheterquerschnittes vorgesehen ist und daß der den Katheter bildende Kunststoffschlauch einen ovalen, ellipsen- oder kreisförmigen Querschnitt hat.

Der Katheter hat also einen stetig umlaufenden Querschnitt, an welchem kein vorspringender Wulst zur Aufnahme des Zugelementes angeordnet ist. Dieses ist vielmehr innerhalb dieses Katheterquerschnittes untergebracht. Parallel zu dem Zugelement ist dann zusätzlich eine Bewehrung ebenfalls innerhalb des Katheterquerschnittes vorgesehen, die den nicht auslenkbaren Bereich so weit aus-

steift, daß bei Betätigung des Zugelementes nur der steuerbare oder biegsame Bereich in erwünschter Weise ausgelenkt wird, während der übrige Teil des Katheters in erwünschter Weise nicht mitverbogen wird. Durch die erwähnte aussteifende, aber biegsame Bewehrung wird aber dennoch der Katheter insgesamt so biegsam gestaltet, daß er problemlos auch durch Blutgefäße eingeführt werden kann. Dennoch wird beim Aktivieren des Manipulators für das Zugelement der Katheter nur an der bewegbaren oder ausbiegbaren Spitze und nicht über seine gesamte Länge gekrümmt.

Eine besonders zweckmäßige Anordnung von eigener erfinderischer Bedeutung kann darin bestehen, daß die Bewehrung ein das Zugelement in sich aufnehmende Führungsrohr aus Metall oder hartem Kunststoff ist, welches innerhalb des Außenquerschnittes des Katheters bis zu dem auslenkbaren Bereich verläuft und dort endet, wo das zum distalen Ende des auslenkbaren Bereiches hin fortgesetzte Zugelement aus dem Führungsrohr austritt.

Wird das Zugelement zum Beispiel durch einen Manipulator betätigt, also eine Zugkraft ausgeübt, wird lediglich der auslenkbare Bereich gebogen, weil in dem übrigen Bereich durch das zwar biegsame aber im wesentlichen widerstandsfähige Führungsrohr der von diesem bewehrte Bereich des Katheters an einer Biegung gehindert wird. Dies rührt daher, daß der auslenkbare Bereich aufgrund seiner Weichheit wesentlich leichter als der mit dem Führungsrohr versehene Bereich gebogen werden kann. Vorteilhaft ist dabei, daß das Zugelement innerhalb des Umrisses des auslenkbaren Bereiches bis zu seiner Befestigungsstelle weiter verläuft.

Das das Zugelement in sich aufnehmende Führungsrohr kann einen Außendurchmesser von etwa einem Drittel oder zwei Fünftel Millimeter bis ungefähr ein Millimeter und einen Innendurchmesser von etwa ein Fünftel bis etwa vier Fünftel Millimeter haben. Somit nimmt es innerhalb des Katheters so wenig Platz ein, daß es gut innerhalb des Umrisses des Katheters untergebracht werden kann und ein gegenüber dem Umriß außen vorstehender Wulst vermieden werden kann.

Der Querschnitt oder Durchmesser des Zugelementes, insbesondere eines Zugdrahtes, Fadens oder Bandes, kann mit einem Spiel von etwa einem Hundertstel bis etwa einem Zehntel Millimeter gegenüber dem Innenquerschnitt des Führungsrohres versehen sein. Dabei kann das Führungsrohr für das Zugelement aus Edelstahl bestehen und das Zugelement vorzugsweise ein Draht, Metallfaden oder Metallband sein. Für die Aufnahme eines Bandes kann dabei das Führungsrohr abgeflacht sein, so daß es in radialer Richtung innerhalb des Katheters

noch weniger Platz benötigt, wenn die längere Querschnittsachse dieses flachen Rohres und die größere breite des Querschnittes des Metallbandes etwa in Umfangsrichtung des Katheters angeordnet sind.

Der Kunststoffschlauch kann zumindest im Bereich der Anordnung des Führungsrohres für das Zugelement eine größere Wandstärke als in dem auf einem Durchmesser etwa gegenüberliegenden Wandbereich haben und das Führungsrohr kann wenigstens teilweise in dem verdickten Wandbereich eingebettet sein. Auf diese Weise kann seine aussteifende Wirkung gut auf die Katheterwandung übertragen werden. Dennoch ist das Führungsrohr mit dem Zugelement innerhalb des Außenumrisses des Katheters untergebracht. In dem verdickten Wandbereich kann benachbart zu dem Führungsrohr wenigstens ein zusätzlich zu dem inneren Kanal paralleler weiterer Kanal mit insbesondere kleinerem Querschnitt verlaufen. Es kann also die Verdickung der Wand zu Unterbringung des Führungsrohres dazu ausgenutzt werden, wenigstens einen weiteren Kanal vorzusehen, so daß beispielsweise durch den Innenkanal größeren Querschnittes ein Instrument oder Endoskop oder dergleichen und durch diesen zweiten Kanal ein Medikament zugeführt werden können.

Eine abgewandelte Ausführung der Erfindung kann darin bestehen, daß der Katheter aus zwei ineinandersteckenden Kunststoffrohren gebildet ist, wobei das äußere Rohr die dichte Außenhülle bildet, und daß das innere Rohr in seiner Längsrichtung mit Abstand zueinander jeweils radial einwärts gerichtete Klemmfinger, Haltezungen oder Laschen zum Festlegen oder Einklemmen den innenseitig verlaufenden Führungsrohres für das Zugelement aufweist. In diesem Falle ist also das Führungsrohr nicht in eine verdickte Wandung des Katheters eingebettet, sondern von entsprechenden Laschen, Fingern oder dergleichen an der Innenseite gehalten.

Die Haltezungen oder dergleichen des inneren Rohres können zusätzlich zu dem insbesondere abgeflachten Führungsrohr ein weiteres Rohr als zusätzlichen Kanal halten. Somit ist auch bei dieser Ausführungsform zusätzlich zu dem Hauptkanal noch ein weiterer paralleler Kanal mit kleinerem Querschnitt möglich. Die Abflachung der Rohre bewirkt dabei eine möglichst geringe Querschnittsverengung des Innenkanales des Katheters, in welchen die Haltezungen und dergleichen für die Festlegung des Führungsrohres etwas hineinragen.

Eine abgewandelte Ausführung der erfindungsgemäßen Lösung, die wiederum eigene erfinderische Bedeutung hat, kann darin bestehen, daß als Bewehrung parallel zu dem exzentrisch angeordneten Zugelement auf der etwa auf einem Durchmesser gegenüberliegenden Seite ein weiteres Zugele-

ment fest installiert ist, welches bis zu dem Beginn des biegsamen Bereiches verläuft und dort befestigt ist. Wird nun eine Zugkraft auf das bewegbare Zugelement ausgeübt, verhindert das ihm am Durchmesser in dem Katheter gegenüberliegende Zugelement eine Biegung oder Krümmung dieses Katheterbereiches, so daß wiederum nur der auslenkbare Bereich des Katheters in erwünschter Weise gekrümmt wird. Dabei könnte diese Anordnung zusätzlich noch mit einem das bewegbare Zugelement in sich aufnehmenden Führungsrohr kombiniert sein, um bei genügend guter Biegsamkeit dieses Katheterbereiches dennoch seine Verformung beim Krümmen des auslenkbaren Bereiches noch besser zu unterbinden. Ein Zugelement als Bewehrung hat den Vorteil, die Biegsamkeit des Katheters selbst, die bei seinem Einführen in Blutgefäße vorteilhaft ist, praktisch nicht zu beeinträchtigen.

Vor allem bei Verwendung eines Zugelementes als Bewehrung kann der dem Katheter bildende Schlauch eine Wand etwa gleichbleibender Dicke haben und an sich auf einem Durchmesser gegenüberliegenden Seiten einerseits einen Kanal für das zum biegen bewegbare Zugelement und andererseits einen Kanal für das unverschiebbare bis zu dem auslenkbaren Bereich führende und dort endende Zugelement insbesondere einen festen Draht oder ein Band zum Beispiel aus Metall, enthalten.

Auch bei dieser Anordnung kann parallel zu den Kanälen für Zugelement und Bewehrung wenigstens ein weiterer Kanal als Zusatzlumen in der Wandung des Katheters angeordnet sein. Somit kann auch bei dieser Anordnung zusätzlich zu dem zentralen oder Haupt-Kanal ein weiterer Kanal kleineren Innenquerschnittes untergebracht werden.

Bei den verschiedenen vorgeschriebenen Ausführungsformen und Ausgestaltungen der Erfindung kann das Zugelement in dem auslenkbaren Bereich ebenfalls in einem separaten Kanal jedoch ohne Aussteifung oder Bewehrung geführt sein. Zwar könnte das Zugelement auch einfach im Inneren des auslenkbaren Bereiches und eines dort vorhandenen Kanales verlaufen, jedoch hat die Einbettung in einem das Zugelement umschließenden Kanal den Vorteil, daß es nicht mit durch diesen Kanal eingeschobenen Instrumenten oder zugeführten Medikamenten oder dergleichen in Berührung kommt.

Dabei ist es zweckmäßig, wenn der Führungskanal für das Zugelement in dem auslenkbaren Bereich eine gegenüber dem Führungsrohr radial um dessen Wandstärke nach außen führenden Übergangsbereich hat und das Zugelement in dem auslenkbaren Bereich etwa den Abstand von der Mittelachse des Katheters hat, den die achsferne Mantellinie des Führungsrohres hat. Dadurch wird

das Zugelement in dem auslenkbaren Bereich so weit wie irgend möglich radial nach außen verlegt, um eine bestmögliche Krümmungswirkung auf diesen auslenkbaren Bereich ausüben zu können, während innerhalb des Führungsrohres dessen Wandstärke zu einem etwas weiter innen liegenden Verlauf dieses Zugelementes führt, wo aber eine Auslenkung durch die Bewehrung unterbunden ist.

Auch wenn kein Führungsrohr vorhanden ist, läuft das Zugelement möglichst an der Außenseite des ausschwenkbaren Bereiches, um eine bis zu 180 Grad gekrümmte Form, also eine halbkreisförmige Krümmung dieses Bereiches durchführen zu können. Dies wird auch dadurch erreicht, daß das Zugelement am distalen Ende (Kopf) des auslenkbaren Bereiches des Katheters befestigt wird.

Vor allem bei Kombination einzelner oder mehrerer der vorgeschriebenen Merkmale und Maßnahmen wird erreicht, daß der Katheter eine genügende Flexibilität haben kann, um beispielsweise auch in Blutgefäße und durch deren Krümmungen eingeführt werden zu können, aber so weit ausgesteift ist, daß die Betätigung des Zugelementes nicht zu einer Krümmung des gesamten Katheters führt, sondern nur die auslenkbare und steuerbare Katheterspitze betrifft. Dennoch kann der Katheter einen stetigen nicht durch einen vorspringenden Wulst veränderten Querschnittsumfang haben und ein im auslenkbaren Bereich liegender Zugdraht mit einer Verletzungsgefahr wird vermieden.

Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigt in zum Teil schematisierter Darstellung:

- 35 Fig.1 einen erfindungsgemäßen steuerbaren Katheter mit auslenkbarem Bereich an seinem distalen Ende und mit einem durch Drehen betätigbaren Manipulator am proximalen Ende,
- 40 Fig.2 in vergrößertem Maßstab die Einzelheit in dem Kreis A in Figur 1, wobei am distalen auslenkbaren Bereich Elektroden zur Aufnahme intrakardialer Signale angedeutet sind,
- 45 Fig.3 in vergrößertem Maßstab einen Längsschnitt durch den Teil des Katheters, an welchem der auslenkbare Bereich beginnt gemäß der Einzelheit B in Figur 1,
- 50 Fig.4 einen Querschnitt gemäß der Linie IV-IV in Figur 3,
- 55 Fig.5 in perspektivischer Darstellung einen Abschnitt des Katheters mit Sicht auf seinen Querschnitt etwa im Bereich der Schnittlinie IV-IV in Figur 3, wobei zusätzliche Kanäle neben dem als Bewehrung dienenden Rohr zur Aufnahme des Zugelementes vorgese-

- hen sind,  
 Fig.6 eine der Figur 5 entsprechende Darstellung einer abgewandelten Ausführungsform, bei welcher als Bewehrung parallel zu dem Zugelement ein weiteres festverankertes Zugteil an einem Durchmesser gegenüberliegend angeordnet ist,  
 Fig.7 eine abgewandelte Ausführungsform des Katheters mit in seinem Inneren angeordnetem Bewehrungs- und Führungsrohr zur Aufnahme des Zugelementes, wobei der Katheter aus zwei Rohren oder Schläuchen besteht, deren Innerer Haltetaschen für das Führungsrohr hat,  
 Fig.8 eine der Figur 7 etwa entsprechende Ausführungsform, bei welcher die Laschen des inneren Katheterschlauches oder -rohres zwei im Querschnitt abgeflachte Rohre halten, deren eines ein Zugelement aufnimmt, während das andere als zusätzlicher Kanal dient,  
 Fig.9 eine teilweise im Längsschnitt gehaltene Anordnung eines am proximalen Ende des Katheters vorgesehenen Schubmanipulators mit Anordnung eines als Bewehrung für den Katheter dienenden Führungsrohres für das Zugelement sowie  
 Fig.10 vergrößertem Maßstab den proximalen Teil des Katheters, an welchem die Eintrittsöffnung für den im Inneren des Katheters verlaufenden Kanal an einem seitlichen Stutzen oder dergleichen vorzugsweise mit einem Schleusenventil sichtbar ist.

Ein im ganzen mit 1 bezeichneter steuerbarer Katheter weist gemäß Figur 1 einen Drehmanipulator 2 und bei einer abgewandelten Ausführungsform gemäß Figur 9 einen Schubmanipulator 3 auf, womit ein auslenkbarer Bereich 4 mit Hilfe der Manipulatoren und eines im Inneren des Katheters 1 oder Katheterschachtes verlaufenden Zugelementes 5 gemäß Figur 1 mehr oder weniger stark biegsam und dadurch steuerbar ist. Somit können beispielsweise an diesem auslenkbaren Bereich 4 oder der distalen Spitze des Katheters 1 vorgesehene Elektroden 6 in einer gewünschten Weise positioniert werden.

Im Inneren hat der Katheter 1 einen hohlen Kanal 7 (Lumen), durch welchen Instrumente, Therapiegeräte, Endoskope oder dergleichen eingeführt werden können.

Das schon erwähnte Zugelement 5 ist gegenüber der axialen Mitte des Katheters 1 exzentrisch angeordnet, so daß eine auf das Zugelement 5 mit

Hilfe eines der Manipulatoren ausgeübten Kraft eine entsprechende Auslenkung des auslenkbaren Bereiches am distalen Ende des Katheters 1 erfolgt. Dadurch läßt sich also die Spitze des Katheters 1 so manipulieren und steuern, daß ein Eintritt in Verzweigungen des Körperhöhlensystemes erleichtert wird. Bis zu dem Auslenkbaren Bereich 4 hin ist das Zugelement 5 in noch zu beschreibender Weise von einer Führung umschlossen.

In allen Ausführungsbeispielen erkennt man, daß der den Katheter 1 bildende Kunststoffschlauch einen stetigen Querschnitt, im Ausführungsbeispiel einen kreisförmigen Querschnitt hat, also kein gegenüber dem eigentlichen Querschnitt seitlich vorstehender Wulst zur Aufnahme des Zugelementes 5 vorhanden ist. Statt einer Kreisform könnte der Querschnitt auch oval oder ellipsenförmig sein.

Das Zugelement 5 und seine Führung verlaufen innerhalb dieses Umrisses des Querschnittes des Katheters 1, wie es in den Figuren dargestellt ist. Damit bei einem Zug auf das Zugelement nur der auslenkbare Bereich 4 und nicht der gesamte Katheter 1 gebogen oder gekrümmt wird, ist bis zu diesem auslenkbaren oder biegsamen Bereich 4 des Katheters hin parallel zu dem Zugelement 5 eine den Katheter 1 gegenüber seinem auslenkbaren Bereich aussteifende Bewehrung ebenfalls innerhalb des Katheterquerschnittes vorgesehen. Vor allem bei einem relativ weichen Werkstoff wird auf diese Weise erreicht, daß bei einem Zug auf das Zugelement 5 nur der auslenkbare nachgiebige Bereich 4 gekrümmt wird, weil die Zugkraft dort auf den geringsten Widerstand stößt. Der übrige Teil des Katheters bleibt jedoch in erwünschter Weise weitgehend unverformt, behält aber gleichzeitig eine genügende Biegsamkeit, um in Körperhöhlen oder Blutgefäße eingeführt werden zu können und dabei auch gewisse Krümmungen und Biegungen mitmachen zu können.

In dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 bis 5 sowie 9 und 10 ist die Bewehrung ein das Zugelement 5 in sich aufnehmendes Führungsrohr 8 aus Metall oder hartem Kunststoff, welches innerhalb des Außenquerschnittes des Katheters 1 bis zu dem auslenkbaren Bereich 4 verläuft, wie man es deutlich in Figur 3 erkennt. Gemäß Figur 3 endet das Führungsrohr 8 also am Beginn des auslenkbaren Bereiches 4, wo das zum distalen Ende des auslenkbaren Bereiches 4 hin fortgesetzte Zugelement 5 also aus dem Führungsrohr 8 austritt. Es verläuft dann weiterhin innerhalb des Umrisses des Katheters und dabei des auslenkbaren Bereiches 4 bis zu seiner Befestigungsstelle am distalen Ende dieses auslenkbaren Bereiches 4.

Wird an dem Zugelement 5 eine Zugkraft ausgeübt, wird also aufgrund der exzentrischen Anord-

nung der auslenkbare Bereich nach der Seiten hin gekrümmt, auf welcher das Zugelement im Inneren dieses auslenkbaren Bereiches 4 verläuft, während gleichzeitig der das Führungsrohr 8 aufweisende Teil des Katheters 1 auch dann weitestgehend unverformt bleibt, wenn der den Katheter 1 bildende Kunststoffschlauch relativ weich ist.

Die Manipulatoren 2 und 3 weisen jeweils eine Eintrittsöffnung 9 auf, die mit dem Lumen oder inneren Kanal 7 des Katheters 1 verbunden ist und durch welche entsprechende Instrumente, weitere Katheter, Elektroden, Endoskope oder sonstige Teile oder auch Medikament oder dergleichen eingeführt werden können.

Das das Zugelement in sich aufnehmende Führungsrohr 8 hat einen relativ geringen Außendurchmesser von etwa einem Millimeter oder sogar weniger, eventuell sogar nur von etwa 0,4 Millimeter oder noch darunter und einen Innendurchmesser von etwa 0,2 bis 0,8 Millimeter, also eine Wandstärke von beispielsweise einem Zehntel Millimeter. Dennoch kann es eine genügende Aussteifung des von ihm durchlaufenden Katheters 1 gegen eine Mitverbiegung bewirken, wenn der auslenkbare Bereich durch Betätigung des Zugelementes 5 gekrümmt wird. Andererseits behindert es nicht eine Einführung des Katheters 1, selbst wenn dieser dabei elastisch gebogen wird.

Der Querschnitt oder Durchmesser des Zugelementes 5 kann im Inneren des Führungsrohres mit einem Spiel von etwa einem Hundertstel bis etwa einem Zehntel Millimeter gegenüber dem Innenquerschnitt versehen sein, was für eine leichtgängige Verschiebung des Zugelementes 5 in dem Führungsrohr 8 genügt, unabhängig davon, ob das Zugelement 5 durch einen Manipulator zum Krümmen zurückgezogen oder durch die Rückstellkraft des auslenkbaren Bereiches 4 wieder in entgegengesetzter Richtung bewegt wird.

Das Führungsrohr 8 für das Zugelement 5 besteht zweckmäßiger Weise aus Edelstahl, um korrosionsfest und unempfindlich gegen Körperflüssigkeiten oder Medikamente zu sein, auch wenn es in die Wandung des Katheters 1 eingebettet ist. Das Zugelement 5 kann ein Draht oder Metallfaden oder auch ein Metallband sein, welches entsprechend flach ist und somit eine Anordnung innerhalb des Katheters 1 mit ganz geringem radialem Platzbedarf erlaubt.

Beim Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 3 bis 5 hat der Kunststoffschlauch, welcher den Katheter 1 im wesentlichen bildet, im Bereich der Unterbringung des Führungsrohres 8 für das Zugelement 5 eine größere Wandstärke als in dem auf einem Durchmesser etwa gegenüberliegenden Wandbereich. Das Führungsrohr 8 ist dabei in diesen verdickten Wandbereich eingebettet. Somit behält der innere Kanal 7 eine regelmäßige, im Aus-

führungsbeispiel kreisförmige Querschnittsform, wobei allerdings dieser Kanal 7 gegenüber der geometrischen Mitte des Katheters 1 oder des ihn bildenden Schlauches etwas seitlich versetzt ist.

In dem verdickten Wandbereich sind gemäß Figur 5 benachbart zu dem Führungsrohr 8 zwei zusätzliche innere Kanäle 10 mit kleinerem Querschnitt als der eigentliche Hauptkanal 7 angeordnet, um zum Beispiel Drähte für Elektrodenpole oder dergleichen oder Thermistoren und Medikamente führen zu können. Der verdickte Wandbereich zur Einbettung des Führungsrohres 8 kann also zur Unterbringung weiterer, von dem eigentlichen inneren Kanal 7 getrennter Kanäle ausgenutzt.

Die Figuren 7 und 8 zeigen eine abgewandelte Ausführungsform des Katheters 1, wobei jeweils nur Abschnitte oder Ausschnitte dieses Katheters 1 in schaubildlicher und geschnittener Darstellung zu sehen sind. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel ist der Katheter 1 aus zwei ineinander gesteckten Kunststoffrohren 11 und 12 gebildet, wobei das äußere Rohr 11 die dichte Außenhülle bildet und das innere Rohr 12 in seiner Längsrichtung mit Abstand zueinander in Reihe nebeneinander jeweils radial einwärts gerichtete Klemmfinger, Haltezungen oder Laschen 13 zum Festlegen oder Einklemmen des innenseitig verlaufenden Führungsrohres 8 für das Zugelement 5 aufweist. Diese Laschen 13 können dabei aus diesem innenliegenden Kunststoffrohr 12 teilweise ausgestanzt und in seinen Innenquerschnitt verformt sein.

Gemäß Figur 8 können dabei diese Haltezungen oder Laschen 13 des inneren Rohres 12 zusätzlich zu dem in diesem Falle abgeflachten Führungsrohr 8 ein weiteres Rohr 14 als zusätzlichen Kanal halten. Somit kann auch bei dieser Katheterausbildung ein von dem eigentlichen Lumen oder Kanal 7 unabhängiger weiterer Kanal vorgesehen werden. Gegebenenfalls können dabei die Rohre 8 und 14 auch durch ein Doppelrohr gebildet sein, welches abgeflacht ist.

Eine abgewandelte Art der Aussteifung oder Bewehrung des Katheters 1 ist in Figur 6 dargestellt. Dabei ist nun vorgesehen, daß als Bewehrung parallel zu dem exzentrisch angeordneten Zugelement 5 auf der etwa einem Durchmesser gegenüberliegenden Seite ein weiteres Zugelement 15 fest installiert ist, welches bis zu dem Beginn des biegsamen Bereiches 4 verläuft und dort befestigt ist. Wird das bewegliche Zugelement 5 im Sinne einer Krümmung des auslenkbaren Bereiches 4 betätigt, verhindert dieses zusätzliche Zugelement 15 eine Krümmung des nicht auslenkbaren Bereiches des Katheters 1. Es wirkt also gewissermaßen als Gegenzugelement. Somit kann das bewegbare und zum Steuern dienende Zugelement 5 in einem in der Wandung des Katheters 1 ange-

ordneten Kanal verlaufen. Denkbar wäre allerdings, daß sowohl ein Führungsrohr 8 als auch ein solches zusätzliches Zugelement 15 als Bewehrungen gemeinsam vorgesehen sind. Dabei ist in Figur 6 das Gegenzugelement 15 dicker als das bewegliche Zugelement 5 dargestellt; es kann jedoch dieselbe Dicke wie Zugelement 5 haben oder ggf. sogar dünner sein.

In Figur 6 erkennt man, daß der den Katheter 1 in diesem Ausführungsbeispiel bildende Schlauch eine Wand etwa gleichbleibender Dicke hat und an sich auf einem Durchmesser gegenüberliegender Seiten einerseits einen Kanal für das zum Biegen bewegbare Zugelement 5 und andererseits einen Kanal für das unverschiebbare, bis zu dem auslenkbaren Bereich 4 führende und dort endende Zugelement 15, insbesondere einen festen Draht oder ein Band zum Beispiel aus Metall, enthält. Parallel zu diesen Kanälen für Zugelement 5 und Bewehrung 15 sind wiederum weitere Kanäle 10 als Zusatzlumen in der Wandung dieses Katheters 1 angeordnet.

In Figur 3 erkennt man noch, daß das Zugelement 5 in dem auslenkbaren Bereich 4 ebenfalls in einem separaten Kanal 16 jedoch ohne Aussteifung oder Bewehrung geführt ist, der soweit wie möglich von der Mitte des Katheters 1 beziehungsweise des auslenkbaren Bereiches 4 nach außen verlegt ist.

Falls das Zugelement 5 bis zu dem bewegbaren Bereich 4 hin in einem Führungsrohr 8 geführt ist - wie Figur 3 es zeigt - ist es günstig, wenn der Führungskanal 16 für das Zugelement 5 in dem auslenkbaren Bereich 4 des Katheters 1 einen gegenüber dem Führungsrohr 8 radial um dessen Wandstärke nach außen führenden Übergangsbereich 17 hat, damit das Zugelement 8 wirklich so weit wie möglich an die Außenseite dieses bewegbaren Bereiches 4 verlegt werden kann, um unter einem möglichst großen Hebelarm eine Krümmung bewirken zu können. Das Zugelement 5 hat in diesem auslenkbaren Bereich 4 gemäß Figur 3 etwa den Abstand von der Mittelachse des Katheters 1, den die achsferne Mantellinie des Führungsrohres 8 von dieser Mitte hat. Man erkennt in Figur 3, daß das Zugelement in dem Übergangsbereich 17 geringfügig weiter nach außen hin ausgelenkt wird und dann etwa in Verlängerung der außenliegenden Wandung des Führungsrohres 8 weiterverläuft.

Insgesamt ergibt sich ein Katheter 1, der von einem Kunststoffschlauch gebildet ist und eine entsprechende Biegsamkeit und Anpassungsfähigkeit hat, um gut in Körperhöhlensysteme eingeführt werden zu können, insbesondere in Blutgefäße. Dabei kann sein auslenkbarer Bereich 4 mit Hilfe des innenliegenden Zugelementes 5 manipuliert werden, ohne daß das Zugelement 5 an irgend

einer Stelle aus dem Katheter 1 oder dem auslenkbaren Bereich 4 austreten muß. Dennoch wird eine Krümmung des nicht auszulenkenden Teiles des Katheters 1 durch eine Bewehrung vermieden, die ein Führungsrohr zum Umschließen des Zugelementes 5 oder ein diesem am Durchmesser gegenüberliegendes weiteres Zugelement 15 sein kann. Somit wird bei der Betätigung des Zugelementes 5 der auslenkbare Bereich 4 um bis zu 180° oder sogar darüber hinaus gekrümmt, ohne daß der übrige Katheterschaft ebenfalls in unerwünschter Weise gekrümmt wird.

Der Katheter 1, welcher von einem biegsamen Kunststoffschlauch gebildet ist, hat in seinem Inneren einen hohlen Kanal 7 und an seinem distalen Ende einen auslenkbaren Bereich 4, um beim Einführen in Abzweigungen beispielsweise von Blutgefäßen gesteuert werden zu können. Zum Auslenken des Bereiches 4 dient ein exzentrisch zur Mitte verlaufendes Zugelement 5, welches von einer eigenen Führung umschlossen ist. Der Katheter 1 hat dabei einen regelmäßigen kreisförmigen, ovalen oder ellipsenförmigen Querschnitt und das Zugelement 5 und seine Führung sind innerhalb des Umrisses dieses Querschnittes untergebracht. Damit der Katheter nur in seinem auslenkbaren Bereich 4 und nicht in dem dazu hinführenden Bereich gekrümmt wird, wenn an dem Zugelement 5 eine Zugkraft aufgebracht wird, weist der Katheter 1 eine bis zu dem auslenkbaren oder biegsamen Bereich 4 etwa parallel zu dem Zugelement 5 verlaufende, den nicht auslenkbaren Bereich aussteifende, aber etwas biegsame Bewehrung ebenfalls innerhalb des Katheterquerschnittes auf. Diese Bewehrung kann ein das Zugelement 5 als Führung in sich aufnehmendes Führungsrohr 8 aus Metall oder hartem Kunststoff und/oder ein weiteres Zugelement 15 sein, welches parallel zu dem bewegbaren Zugelement 5 auf einer etwa auf einem Durchmesser gegenüberliegenden Seite des Katheters fest installiert ist und nur bis zu dem auslenkbaren Bereich 4 verläuft.

## Patentansprüche

1. Katheter (1) mit wenigstens einem in seinem Inneren verlaufenden hohlen Kanal (7) oder Lumen, welcher Katheter (1) im wesentlichen von einem biegsamen Kunststoffschlauch gebildet ist, wobei das distale Ende des Katheters (1) mittels eines gegenüber seiner axialen Mitte exzentrisch angeordneten, über die wesentliche Länge des Katheters (1) verlaufenden Zugelementes (5) zum mehr oder weniger starken Biegen und dadurch zum Steuern des Spitzes des Katheters (1) für den Eintritt in Verzweigungen des Körperhöhlensystemes, zum Beispiel Blutgefäße, elastisch biegsam



- oder auslenkbar ist und wobei das Zugelement (5) bis zu dem auslenkbaren Bereich (4) von einer eigenen Führung umschlossen ist, wobei das Zugelement (5) und seine Führung innerhalb des Umrisses des Querschnittes des Katheters verläuft, **dadurch gekennzeichnet**, daß bis zu dem auslenkbaren oder biegsamen Bereich (4) des Katheters (1) parallel zu dem Zugelement (5) eine den Katheter (1) gegenüber seinem auslenkbaren Bereich aussteifende Bewehrung ebenfalls innerhalb des Katheterquerschnittes vorgesehen ist und daß der den Katheter (1) bildende Kunststoffschlauch einen ovalen, ellipsen- oder kreisförmigen Querschnitt hat.
2. Katheter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Umriss des Querschnittes des Katheters (1) stetig und vorsprungfrei ist.
  3. Katheter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bewehrung ein das Zugelement (5) in sich aufnehmendes Führungsrohr (8) aus Metall oder gegebenenfalls hartem Kunststoff ist, welches innerhalb des Außenquerschnittes des Katheters (1) bis zu dem auslenkbaren Bereich (4) verläuft und dort endet, wo das zum distalen Ende des auslegbaren Bereiches (4) hin fortgesetzte Zugelement (5) aus dem Führungsrohr (8) austritt und insbesondere innerhalb des Umrisses des auslenkbaren Bereiches (4) zu seiner distalen Befestigungsstelle weiterläuft.
  4. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das das Zugelement (5) in sich aufnehmende Führungsrohr (8) einen Außendurchmesser von etwa einem Drittel oder zwei Fünftel Millimeter bis ungefähr ein Millimeter und einen Innendurchmesser von etwa einem Fünftel bis etwa vier Fünftel Millimeter hat.
  5. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Querschnitt oder Durchmesser des Zugelementes (5), insbesondere eines Zugdrahtes, Fadens oder Bandes, mit einem Spiel von etwa einem Hundertstel bis etwa einem Zehntel Millimeter gegenüber dem Innenquerschnitt des Führungsrohres (8) versehen ist.
  6. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungsrohr (8) für das Zugelement (5) aus Edelstahl besteht und das Zugelement (5) insbesondere ein Draht, Metallfaden oder Metallband ist.
  7. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der den Katheter (1) bildende Kunststoffschlauch zumindest im Bereich der Anordnung des Führungsrohres (8) für das Zugelement (5) eine größere Wandstärke als in dem auf einem Durchmesser etwa gegenüberliegenden Wandbereich hat und daß das Führungsrohr (8) wenigstens teilweise in den verdickten Wandbereich eingebettet ist.
  8. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß in dem verdickten Wandbereich benachbart zu dem Führungsrohr (8) wenigstens ein zusätzlich zu dem inneren Kanal (10) paralleler weiterer Kanal (10) mit insbesondere kleinerem Querschnitt als der des inneren Kanals (7) verläuft.
  9. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Katheter (1) aus zwei ineinandersteckenden Kunststoffrohren (11, 12) oder Kunststoffschläuchen gebildet ist, wobei das äußere Rohr (11) die dichte Außenhülle bildet, und daß das innere Rohr (12) in seiner Längsrichtung mit Abstand zueinander jeweils radial einwärts gerichtete Klemmfinger, Haltezungen oder Laschen (13) zum Festlegen oder Einklemmen des innenseitig verlaufenden Führungsrohres (8) für das Zugelement (5) aufweist.
  10. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Haltezungen, Laschen (13) oder dergleichen des inneren Rohres (12) zusätzlich zu dem insbesondere abgeflachten Führungsrohr (8) ein weiteres Rohr (14) als zusätzlichen Kanal halten.
  11. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Bewehrung oder zusätzliche Bewehrung parallel zu dem exzentrisch angeordneten Zugelement (5) auf der etwa auf einem Durchmesser gegenüberliegenden Seite ein weiteres Zugelement (5) als Gegenzugelement fest installiert ist, welches bis zu dem Beginn des biegsamen Bereiches (4) verläuft und dort sowie am proximalen Ende des Katheters (1) unverschiebbar befestigt ist.
  12. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der ihn bildende Kunststoffschlauch eine Wand etwa gleichbleibender Dicke hat und an sich auf einem Durchmesser gegenüberliegenden Seiten einerseits einen Kanal für das zum Biegen relativ zum Katheter (1) bewegbaren Zugelement (5) und andererseits einen Kanal für das unver-



schiebbare, bis zu dem auslenkbaren Bereich (4) führende und dort endende Zugelement (15), insbesondere einen festen Draht oder ein Band zum Beispiel aus Metall, enthält.

5

13. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zu den Kanälen für Zugelement (5) und als Bewehrung dienendes Gegenzugelement (15) wenigstens ein weiterer Kanal (10) als Zusatzlumen in der Wand des Katheters (1) angeordnet ist. 10
14. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Zugelement (5) in dem auslenkbaren Bereich (4) ebenfalls in einem von dem inneren Kanal (7) getrennten separaten Kanal (16) jedoch ohne Aussteifung oder Bewehrung geführt ist. 15
15. Katheter nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Führungskanal (16) für das Zugelement (5) in dem auslenkbaren Bereich (4) einen gegenüber dem Führungsrohr (8) radial etwa um dessen Wandstärke nach außen führenden Übergangsbereich (17) hat und daß das Zugelement (5) in dem auslenkbaren Bereich (4) etwa den Abstand von der Mittelachse des Katheters hat, den die Wandung des Führungsrohres im Bereich ihrer achsfernen Mantellinie hat. 20 25 30


35



40



45



50


55

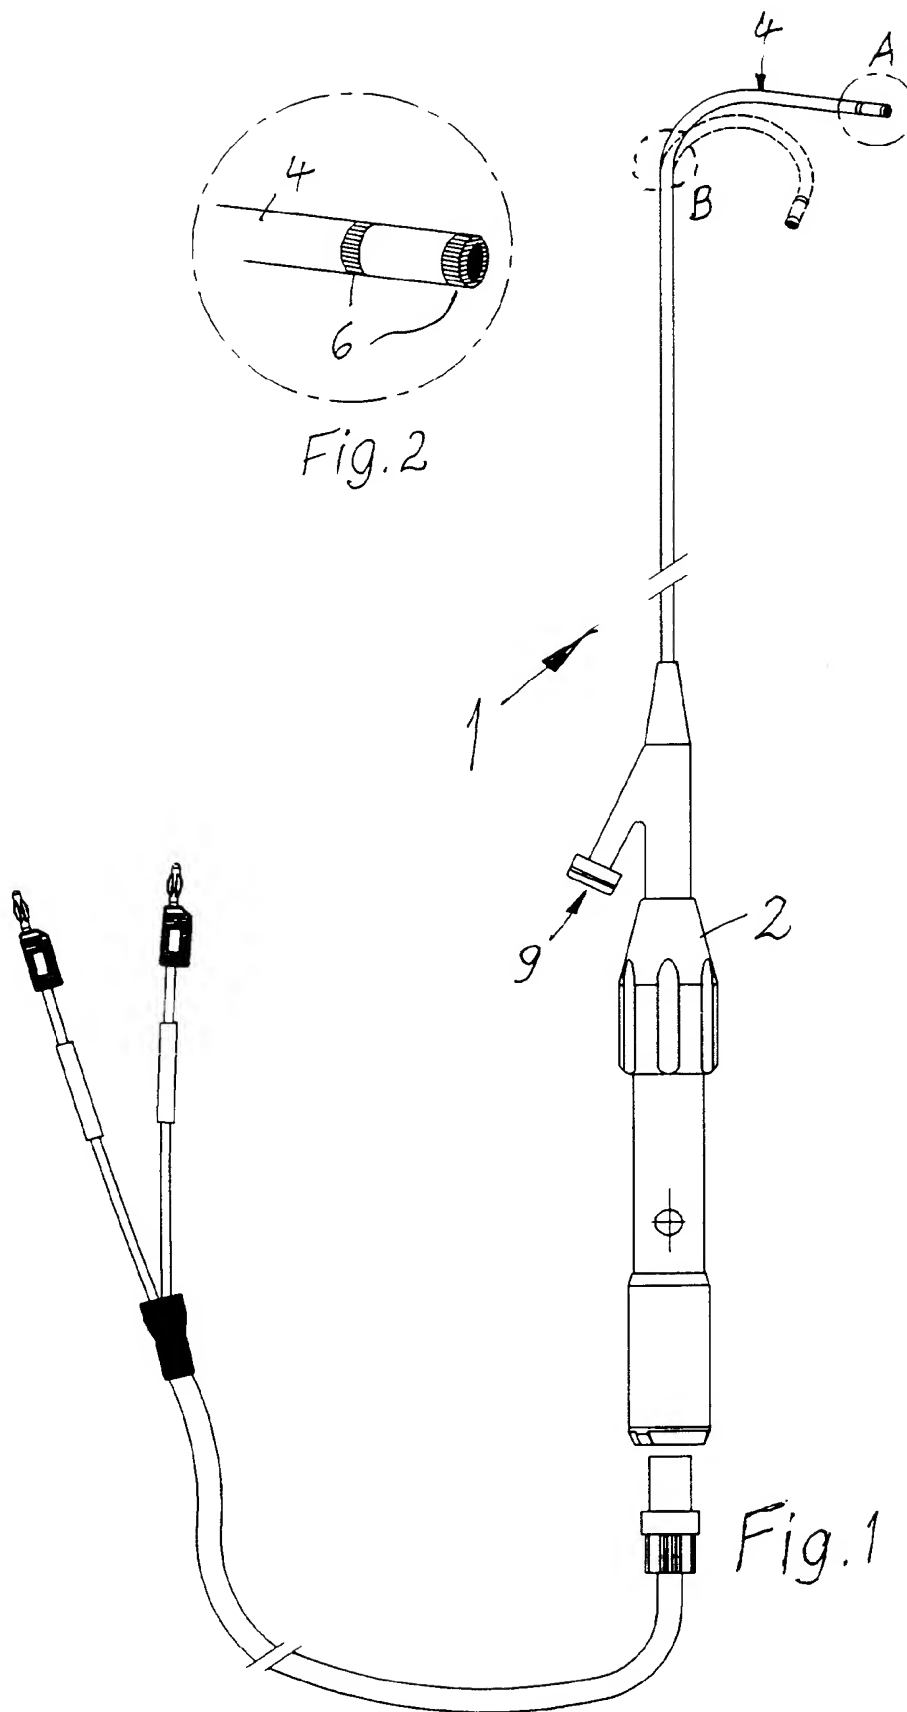

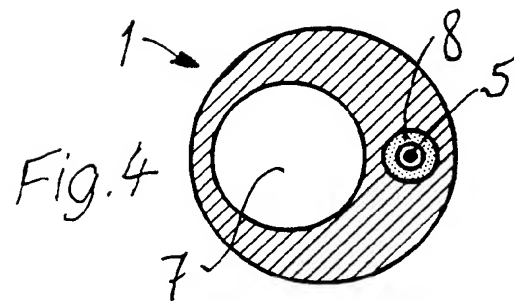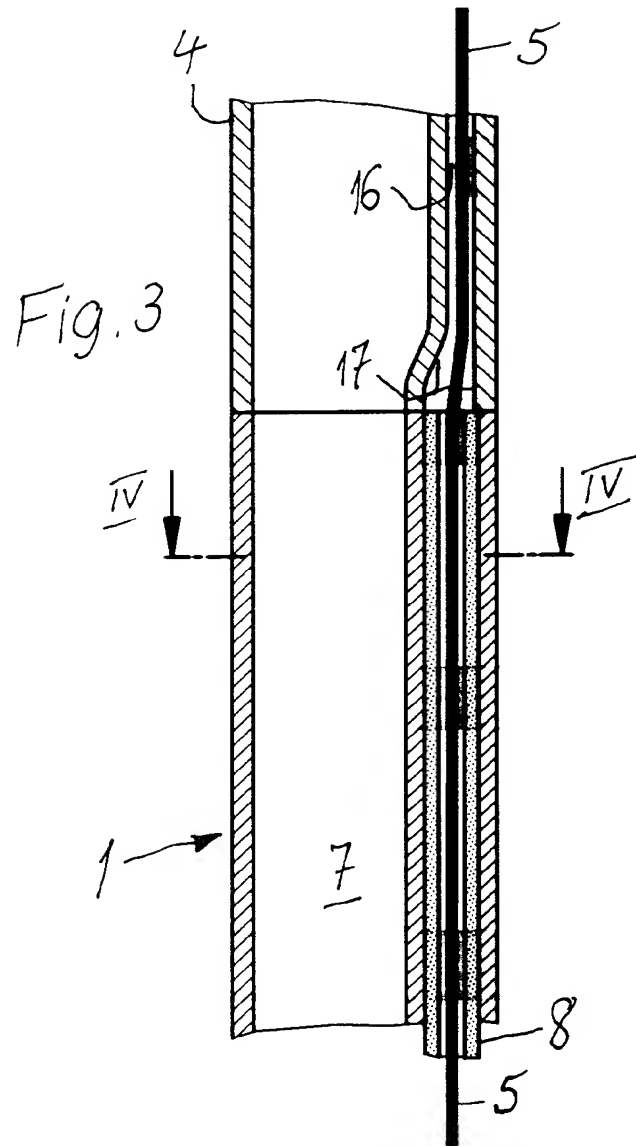

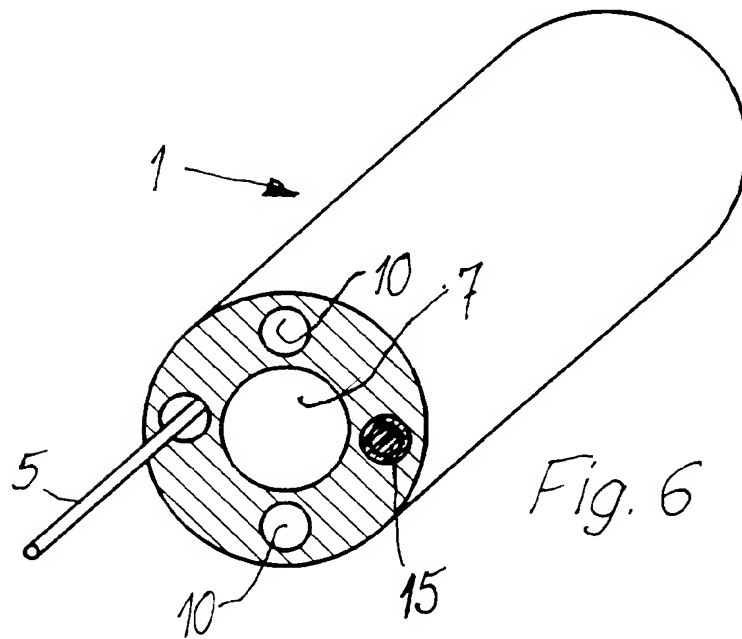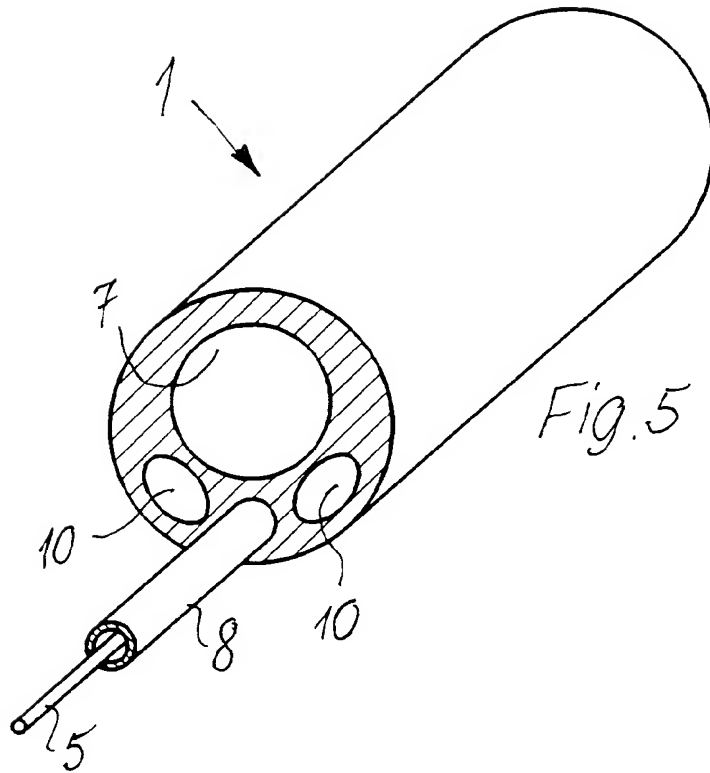

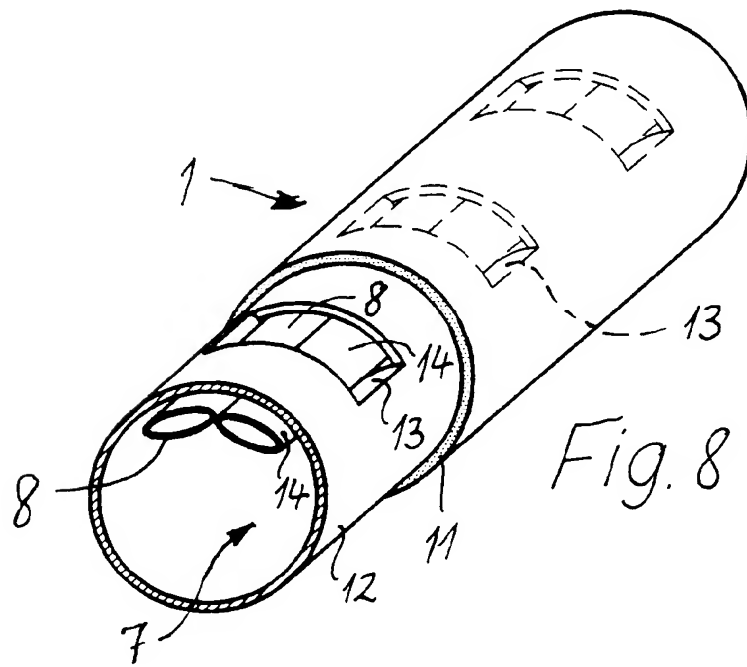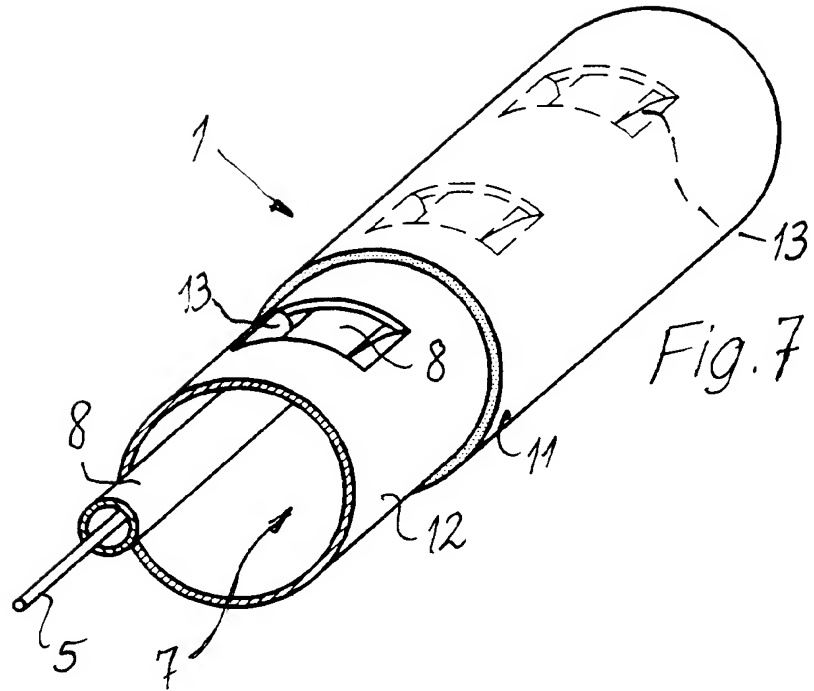

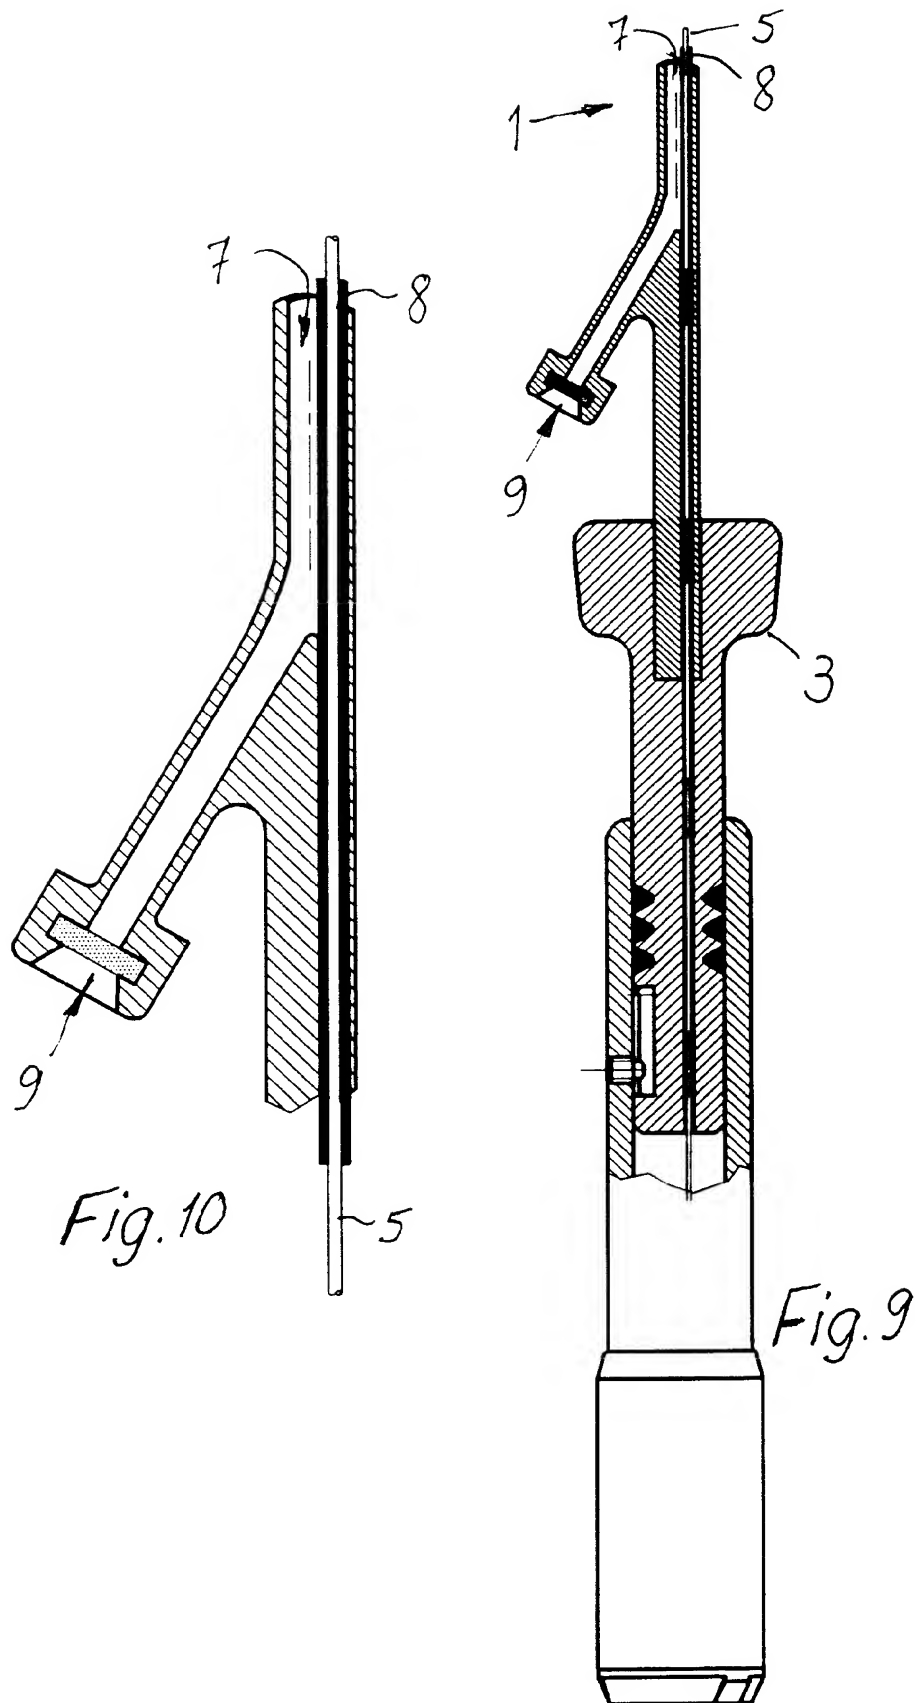



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 10 8025

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
X	WO-A-92 14506 (RAYCHEM CORP.) * Seite 2, Zeile 4 - Zeile 18 * * Seite 3, Zeile 7 - Zeile 11 * * Seite 7, Zeile 4 - Zeile 31 * * Seite 12, Zeile 10 - Zeile 14; Ansprüche 1,16,17,28,32; Abbildungen 3A,B,13A,B *	1-3,6,14	A61M25/01 A61M25/00
A	---	4,5, 7-13,15	
X	EP-A-0 543 539 (INELLIWIRE, INC.) * Spalte 2, Zeile 51 - Spalte 4, Zeile 19 * * Spalte 4, Zeile 54 - Spalte 5, Zeile 25; Ansprüche 1,2; Abbildungen 2-5,9,11,12 *	1,2	
A	---	3-6,9-15	
A	US-A-5 041 085 (OSBORNE ET AL.) ---		
A,D	DE-A-39 20 707 (FOERSTER ET AL.) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
			A61M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 5. Oktober 1994	Prüfer Michels, N
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	